


دستگاه ریز بُر

(Microtome)

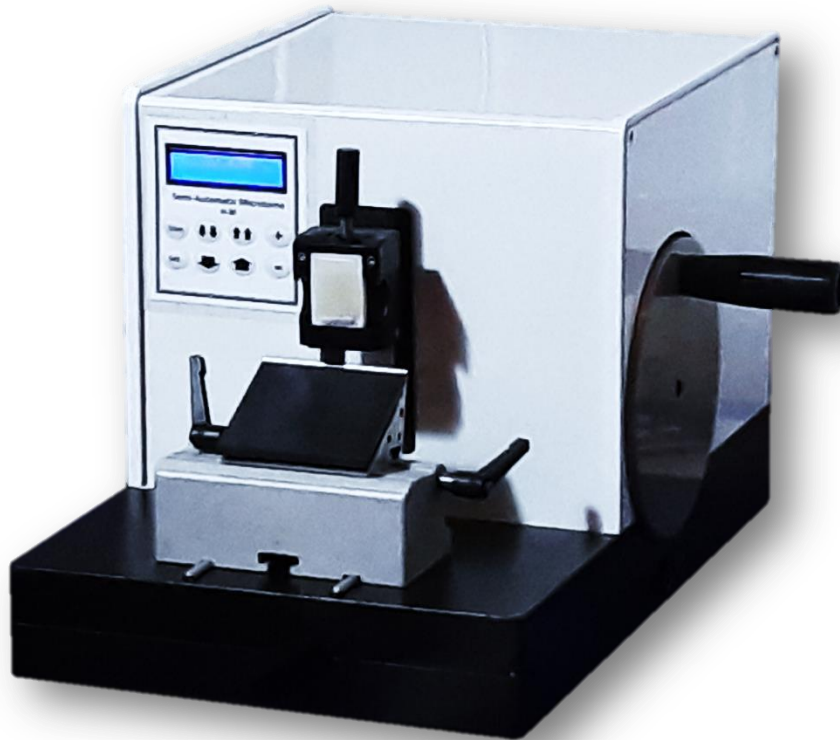

شرکت علامه رایانه صنعت

تولید و تعمیر تجهیزات پاتولوژی

تلفکس: ۰۳۱۴۵۸۳۸۷۴۲

همراه: ۰۹۰۲۱۱۳۵۶۷۰ - ۲

تارنما: www.Allamehrs.ir

رایانامه: ARSCo@chmail.ir

مشخصات کلی

- ✓ وزن: ۲۸ کیلوگرم
- ✓ ابعاد: ۳۰H×۴۰W×۵۰L سانتیمتر
- ✓ رنگ بدنه از نوع الکترواستاتیک

- ✓ ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
- ✓ حداکثر جریان مصرفی: ۰.۱ آمپر

- ✓ نیمه اتوماتیک (کنترل الکترونیکی میکرون دهی)
- ✓ برش از ضخامت ۰.۵ الی ۴۰ میکرون در حالت "برش" و دقت تنظیم (افزایش/کاهش) ۱ میکرون.
- ✓ برش از ضخامت ۱۰ الی ۱۰۰ میکرون در حالت "تریم" (trim) و دقت تنظیم (افزایش/کاهش) ۵ میکرون.
- ✓ بازگشت به عقب فک پس از هر برش (Retraction)
- با قابلیت تنظیم یا حذف
- ✓ بازه حرکت افقی فک بلوک گیر ۲۴mm
- ✓ بازه حرکت عمودی فک بلوک گیر ۶۰mm
- ✓ گیره فک برای گیرش قالب‌های بافت قدیمی بلوکی شکل یا قالب‌های جدید تیشوتک (طبق سفارش)
- ✓ دسته‌ای روان و سبک که موجب خستگی زودهنگام کاربر نمی‌شود